



## **FICHA TECNICA MASCARILLA-FLUMISA**

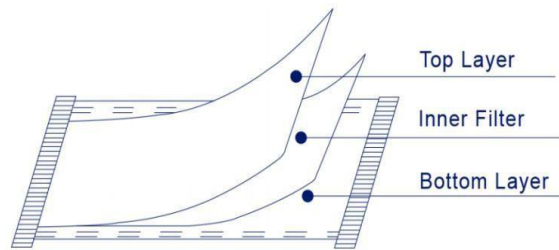

### **Mascarilla Desechable no Tejida c/ gancho de 3 capas**

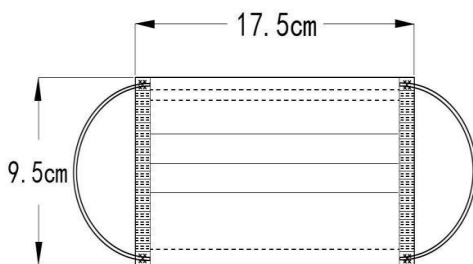

|                                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>                          | SBPP+Papel de filtro fundido fundido+SBPP                                                                                                                                                                              |
| <b>Primera capa (PP)</b>                 | PP no tejido Peso: 25gsm                                                                                                                                                                                               |
| <b>Capa intermedia (papel de filtro)</b> | Papel de filtro soplado fundido N95 (BFE: 95%): 25gsm                                                                                                                                                                  |
| <b>Tercera capa (PP)</b>                 | PP no tejido Peso: 25gsm                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tamaño</b>                            | 17.5 * 9.5 cm                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Característica</b>                    | De un solo uso, ecológico, biodegradación, transpirable y suave, libre de látex y fibra de vidrio, barra de clip nasal ajustable<br>anti polvo, anti bacteriano, anti virus, anti polen, anti smog, anti gotitas, etc. |
| <b>Estilo</b>                            | Earloop (con elástico), elástico exterior / elástico interior                                                                                                                                                          |
| <b>Color</b>                             | azul, blanco                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Paquete</b>                           | 50pcs/box, 100box/ctn (5000pcs/ctn) Ctn tamaño: 52*38*30cm; Peso bruto: 8kg/ctn                                                                                                                                        |
| <b>Aplicación</b>                        | Ampliamente utilizado para Médico / Industrial / Alimentos / Belleza / Sala limpia / Personal, etc.                                                                                                                    |


PROTOCOLO DE ANÁLISIS (Mascarilla)

|                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                           |             |                                     |                  |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-----------|
| Descripción<br>描述                                                    | Mascarilla desechable 3layer Con<br>Elastico            口罩                                                                                                                             |                           | Color 颜色    | Blanco                              | LOTE<br>批次号      | 20240627  |
| Cantidad<br>(Unids) 生产<br>数量                                         | 2,600,000<br>unids                                                                                                                                                                     | Cantidad (Cartón)         | 520 Cartóns |                                     | Muestreo<br>抽样数量 | 2 Cartóns |
| Fecha de<br>producción;<br>Fecha de<br>Vencimiento<br>生 产 日 期<br>有效期 | 07/2024<br>07/2029                                                                                                                                                                     | Fecha de muestreo<br>抽样日期 | 2024.7.22   | Fecha de<br>la prueba<br>检 测 日<br>期 | 2024.7.22        |           |
| Paquete<br>包装                                                        | 50piezas/bolsa, 100bolsas/caja 5000 piezas/caja cada caja colocará 100 piezas de cajas internas vacías. tamaño de la caja interna: 18*10*7 cm, tamaño de la caja exterior: 52*38*38 cm |                           |             |                                     |                  |           |

| Elementos de prueba<br>测试项目   | Requerimientos técnicos 技术要求                                                                                                       | Resultado<br>测试结果       | Conclusión 结论 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Proceso de producción<br>生产工艺 | hecho a máquina                                                                                                                    | Pasar                   | Pasar         |
| Estilo 样式                     | con gancho (elástico exterior)                                                                                                     | Pasar                   | Pasar         |
| Apariencia exterior<br>外观     | Bien distribuido en color, Sin sustancias extrañas mecánicas, Sin olor desagradable                                                | Pasar                   | Pasar         |
| 缝制要求<br>Requisitos de costura | Calentamiento ultrasónico                                                                                                          | Pasar                   | Pasar         |
| 主要材料<br>material principal    | primera capa: telas no tejidas spunbond<br>segunda capa: telas no tejidas fundidas<br>por soplado tercera capa: spunbond no tejido | Pasar                   | Pasar         |
| 材料克重<br>Peso material         | 1. 25gsm ± 2gsm<br>2. 25gsm ± 2gsm<br>3. 25gsm ± 2gsm                                                                              | 24gsm<br>29gsm<br>24gsm | Pasar         |
| 基本尺寸<br>Estándar de tamaño    | 17.5*9.5cm ± 1cm                                                                                                                   | 17.4*9.5cm              | Pasar         |

  
Juan José Herencia Ortega  
DNI N° 09931834  
Address: Room 2607/2608, Building 2, Oceanwide International Soho Town, Jiangnan District, Wuhan City,  
Hubei Province, P.R. China. Tel: 86 27 83610770  
REPRESENTANTE LEGAL  
FUMISAC, S.L.

**Imágenes:**

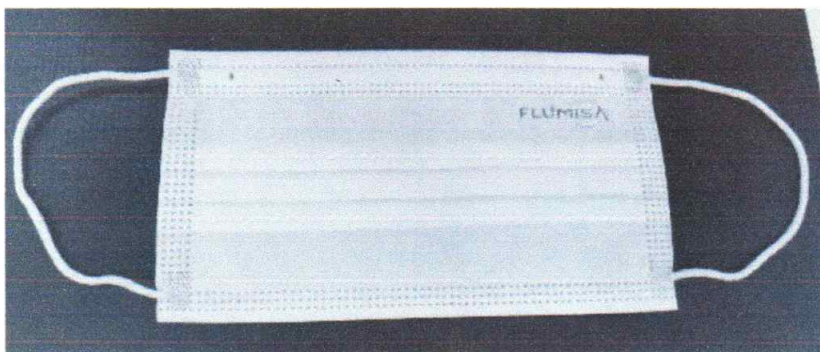

Primera capa:



Segunda capa:



Tercera capa:



Tres capas:

Inspector : KING LI

Conclusión: Este producto ha sido probado y cumple los requisitos: aceptable

  
**Juan José Herencia Ortega**  
DNI: N° 09931834

REPRESENTANTE LEGAL

Address: Room 2607/2608, Building 2, Oceanwide International Soho Town, Jiangnan District, Wuhan City,  
Hubei Province, China Tel: 86 27 83610770



# HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

## PROTOCOLO DE ANÁLISIS (Mascarilla)

|                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                           |             |                                     |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-----------|
| Descripción<br>描述                                                     | Mascarilla desechable 3layer Con<br>Elastico            口罩                                                                                                                             |                           | Color 颜色    | Celeste                             | LOTE<br>批次号      | 20250509  |
| Cantidad<br>(Unids) 生产<br>数量                                          | 4,320,000<br>unids                                                                                                                                                                     | Cantidad (Cartón)         | 864 Cartóns |                                     | Muestreo<br>抽样数量 | 2 Cartóns |
| Fecha de<br>producción ;<br>Fecha de<br>Vencimiento<br>生 产 日 期<br>有效期 | 05/2025<br>05/2030                                                                                                                                                                     | Fecha de muestreo<br>抽样日期 | 2025.6.12   | Fecha de<br>la prueba<br>检 测 日<br>期 | 2025.6.12        |           |
| Paquete<br>包装                                                         | 50piezas/bolsa, 100bolsas/caja 5000 piezas/caja cada caja colocará 100 piezas de cajas internas vacías. tamaño de la caja interna: 18*10*7 cm, tamaño de la caja exterior: 52*38*38 cm |                           |             |                                     |                  |           |

| Elementos de prueba<br>测试项目   | Requerimientos técnicos 技术要求                                                                                                       | Resultado<br>测试结果       | Conclusión 结论 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Proceso de producción<br>生产工艺 | hecho a máquina                                                                                                                    | Pasar                   | Pasar         |
| Estilo 样式                     | con gancho (elástico exterior)                                                                                                     | Pasar                   | Pasar         |
| Apariencia exterior<br>外观     | Bien distribuido en color, Sin sustancias extrañas mecánicas, Sin olor desagradable                                                | Pasar                   | Pasar         |
| 缝制要求<br>Requisitos de costura | Calentamiento ultrasónico                                                                                                          | Pasar                   | Pasar         |
| 主要材料<br>material principal    | primera capa: telas no tejidas spunbond<br>segunda capa: telas no tejidas fundidas por soplado<br>tercera capa: spunbond no tejido | Pasar                   | Pasar         |
| 材料克重<br>Peso material         | 1. 25gsm ± 2gsm<br>2. 25gsm ± 2gsm<br>3. 25gsm ± 2gsm                                                                              | 25gsm<br>25gsm<br>25gsm | Pasar         |
| 基本尺寸<br>Estándar de tamaño    | 17.5*9.5cm ± 1cm                                                                                                                   | 17.5*9.4CM              | Pasar         |


Address: Room 2404, Building 7, Oceanwide International Soho Town, Jiangnan District, Wuhan City, Hubei Province, China    Tel: 86 27 83888528

# HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

---



Imágenes:



Primera capa:



Segunda capa:



Third layer:



Tres capas: 75 gsm:

Inspector : KING LI

Conclusión: Este producto ha sido probado y cumple los requisitos. acceptable

Address: Room 2404, Building 7, Oceanwide International Soho Town, Jiangnan District, Wuhan City, Hubei Province, China Tel: 86 27 83888528





# 检测报告

## (Test Report)

No. BOLW4B4T063357L1

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 样品名称<br>(Sample Description) | 一次性口罩<br>DISPOSABLE FACE MASK                                   |
| 委托单位<br>(Applicant)          | 仙桃市佳宏防护用品有限公司<br>XIANTAO JIAHONG PROTECTIVE<br>PRODUCTS CO.,LTD |
| 生产单位<br>(Production)         | 仙桃市佳宏防护用品有限公司<br>XIANTAO JIAHONG PROTECTIVE<br>PRODUCTS CO.,LTD |
| 检测类别<br>(Test Type)          | 委托检测<br>(Commissioning Test)                                    |



## 声 明 Statement

1. 本报告无专用章和批准人签章无效。  
This report is invalid without the approver's signatures and special seal of inspection.
2. 本报告页面所使用“PONY”、“谱尼”字样为本单位的注册商标,其受《中华人民共和国商标法》保护,任何未经本单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造“PONY”、“谱尼”商标均为违法侵权行为,本单位将依法追究其法律责任。  
The pattern and characters of "PONY" and "谱尼" used in this report are protected by the trademark law of the People's Republic of China. Any unauthorized usage, counterfeit, forgery and alteration of trademarks of "PONY" and "谱尼" are the violations of the law. The PONY has the right to pursue all legal liabilities of the subject of the delict.
3. 委托单位对报告数据如有异议,请于报告完成之日起十五日内(初级农产品报告请于报告收到之日起五日内)向本单位书面提出复测申请,同时附上报告原件并预付复测费。  
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written retest application with the original report, and prepay the retest fees to PONY within fifteen days since the approval date (as an exception, it shall be within five days since the date received for the primary agriculture products report).
4. 委托单位办理完毕以上手续后,本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符,本单位将退还委托单位的复测费。  
After the applicant finishes the procedure mentioned above, PONY shall arrange the retest as soon as possible. If the retest result accords with the applicant dissent, PONY shall refund the retest fees.
5. 不可重复性或不能进行复测的实验,不进行复测,委托单位放弃异议权利。  
Tests that can not be repeated and tested shall not be carried out again.
6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责,否则本单位不承担任何相关责任。  
The applicant should undertake the responsibility for the provided samples' representativeness and document authenticity. Otherwise, PONY has not any relevant responsibilities.
7. 本报告仅对所测样品负责,报告数据仅反映对所测样品的评价,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本单位不承担任何经济和法律责任。  
This report is only responsible for the provided sample. The test results only represent the evaluation of the tested sample. PONY will not be responsible for any economical or legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.
8. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。  
PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report.
9. 本单位保证工作的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。  
PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.
10. 本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制(全文复制除外)或以其它任何形式的篡改均属无效,本单位将对上述行为追究其相应的法律责任。  
The report is invalid in case of illegal transfer, embezzlement, imposture, modification or any altering, reproducing except in full, without approval of PONY. PONY shall investigate and affix the applicant's legal liability accordingly.

### ▲ 防伪说明 (Anti-counterfeiting Description):

- (1) 报告编号是唯一的;  
The test report has exclusive report code.
- (2) 报告采用特制防伪纸张印制,纸张表面带有"PONY"防伪纹路,该防伪纹路不支持复印,即复制件不会带有"PONY"防伪纹路。  
The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any circumstances.



全国服务热线  
400-819-5688

WWW.PONYTEST.COM

扫描二维码  
关注谱尼测试微信公众号  
PONY4008195688



|                        |                        |                         |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 北京实验室: (010) 83055000  | 武汉实验室: (027) 83997127  | 哈尔滨实验室: (0451) 58627755 |
| 上海实验室: (021) 64851999  | 长春实验室: (0431) 85150908 | 石家庄实验室: (0311) 85376660 |
| 青岛实验室: (0532) 88706866 | 大连实验室: (0411) 87336618 | 乌鲁木齐实验室: (0991) 6684186 |
| 深圳实验室: (0755) 26050909 | 郑州实验室: (0371) 69350670 | 呼和浩特实验室: (0471) 3450025 |
| 天津实验室: (022) 23607888  | 西安实验室: (029) 89608785  | 杭州实验室: (0571) 87219096  |
| 苏州实验室: (0512) 62997900 | 太原实验室: (0351) 7555762  | 宁波实验室: (0574) 87736499  |
|                        |                        | 温州实验室: (0577) 88271060  |
|                        |                        | 合肥实验室: (0551) 63843474  |
|                        |                        | 广州实验室: (020) 89224310   |
|                        |                        | 厦门实验室: (0592) 5568048   |
|                        |                        | 成都实验室: (028) 87702708   |

## 检测结果 (Test Results)

No. BOLW4B4T063357L1

第 1 页, 共 2 页 (page 1 of 2)

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 样品名称<br>(Sample Description)                                                        | 一次性口罩<br>DISPOSABLE FACE MASK                                                                                                                                                                           | 样品规格<br>(Sample Specification)                | 规格 Specification:<br>17.5*9.5<br>型号 Model: 平面型                                  |
| 委托单位<br>(Applicant)                                                                 | 仙桃市佳宏防护用品有限公司<br>XIANTAO JIAHONG<br>PROTECTIVE PRODUCTS<br>CO.,LTD                                                                                                                                      | 商标<br>(Trade Mark)                            | ——                                                                              |
| 到样日期<br>(Received Date)                                                             | 2020-05-25                                                                                                                                                                                              | 生产日期或批号<br>(Manufacturing Date or<br>Lot No.) | 生产日期 Manufacturing<br>Date: 20200522<br>生产批号 Manufacturing<br>Lot No.: 20200522 |
| 检测日期<br>(Test Date)                                                                 | 2020-05-22~2020-06-08                                                                                                                                                                                   | 样品等级<br>(Sample Grade)                        | ——                                                                              |
| 样品数量<br>(Sample Quantity)                                                           | 80 个 80pcs                                                                                                                                                                                              | 检测类别<br>(Test Type)                           | 委托检测<br>(Commissioning Test)                                                    |
| 样品状态<br>(Sample Status)                                                             | 正常 Normal                                                                                                                                                                                               | 检测环境<br>(Test Environment)                    | 符合要求<br>(To meet the requirements)                                              |
| 检测项目<br>(Test Items)                                                                | 见下页 See the next page                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                 |
| 检测方法<br>(Test Methods)                                                              | 见下页 See the next page                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                 |
| 所用主要仪器<br>(Main Instruments)                                                        | 电热恒温培养箱 Electric Heating Constant Temperature Incubator、<br>细菌过滤效率检测仪 Bacterial filtration efficiency detector 等 etc.                                                                                   |                                               |                                                                                 |
| 备注<br>(Note)                                                                        | 限值标准 Limit Standard: EN 14683: 2019<br>受检单位 Inspection: 仙桃市佳宏防护用品有限公司<br>XIANTAO JIAHONG PROTECTIVE PRODUCTS CO.,LTD<br>以上样品信息由委托单位提供<br>The information of above sample was provided by the applicant. |                                               |                                                                                 |
|  | 编制人<br>(Edited by)                                                                                                                                                                                      | [Signature]                                   |                                                                                 |
|                                                                                     | 审核人<br>(Checked by)                                                                                                                                                                                     | [Signature]                                   |                                                                                 |
|                                                                                     | 批准人<br>(Approved by)                                                                                                                                                                                    | [Signature]                                   |                                                                                 |
|                                                                                     | 签发日期<br>(Issued Date)                                                                                                                                                                                   | 2020-06-08                                    |                                                                                 |

## 检测结果 (Test Results)

No. BOLW4B4T063357L1

第 2 页, 共 2 页 (page 2 of 2)

| 样品名称和编号<br>(Sample Description<br>and Number) | 检测项目<br>(Test Items)                                          | 限值<br>(Limit) |                 |                     | 检测结果<br>(Test Results)                                        |  | 检测方法<br>(Test Methods) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|------------------------|
|                                               |                                                               | I 型<br>Type I | II 型<br>Type II | II R 型<br>Type II R |                                                               |  |                        |
| T063357L1<br>一次性口罩<br>DISPOSABLE<br>FACE MASK | 细菌过滤效率<br>(BFE), %<br>Bacterial filtration<br>efficiency(BFE) | ≥95           | ≥98             | ≥98                 | No.1 99.8<br>No.2 99.7<br>No.3 99.7<br>No.4 99.8<br>No.5 99.8 |  | EN 14683: 2019         |
|                                               | 压力差, Pa/cm <sup>2</sup><br>Differential pressure              | <40           | <40             | <60                 | 26.6                                                          |  | EN 14683: 2019         |
|                                               | 抗溅压力, kPa<br>Splash resistance<br>pressure                    | /             | /               | ≥16.0               | >16.0                                                         |  | EN 14683: 2019         |
|                                               | 微生物清洁度, cfu/g<br>Microbial cleanliness                        | ≤30           | ≤30             | ≤30                 | <1                                                            |  | EN 14683: 2019         |

样品编号和照片 (Sample Number and Photo):



仅对报告照片中的样品负责

Pony authenticate the photo on original report only

——以下空白——

(End of Report)

